

声 明

一、本机构对委托单位提供的样品和相关技术资料保密。

二、检测报告送达加方单位，请于收到报告之日起7天内作出书面回复或在



YBC20220783


国家食品药品监督管理总局 浙江药品包装材料检验中心 检验报告书

检验报告专用章


报告书编号:YBC20220783

第 1 页 共 1 页


检品名称	双向拉伸聚丙烯透明管假药瓶是聚烯烃类复合膜		
批号	220404	规格	0.048*140mm
生产单位	浙江医药股份有限公司	送检人	陈利军
生产地址	浙江台州医药有限公司	检验项目	红外光谱
检验目的	合同检验	收检日期	2022/05/16
检验项目	红外光谱	报告日期	2022/06/14
检验依据	国家药包材标准 YBB00192002-2015	标准规定	检验结果
检验项目			
【鉴别】			
红外光谱	BOPP层 VMCPP层	应与对照图谱基本一致 应与对照图谱基本一致	与对照图谱基本一致 与对照图谱基本一致
【异常毒性】		应符合规定	符合规定
----以下空白----			




授权签字人		签发日期	2022/06/14
-------	--	------	------------

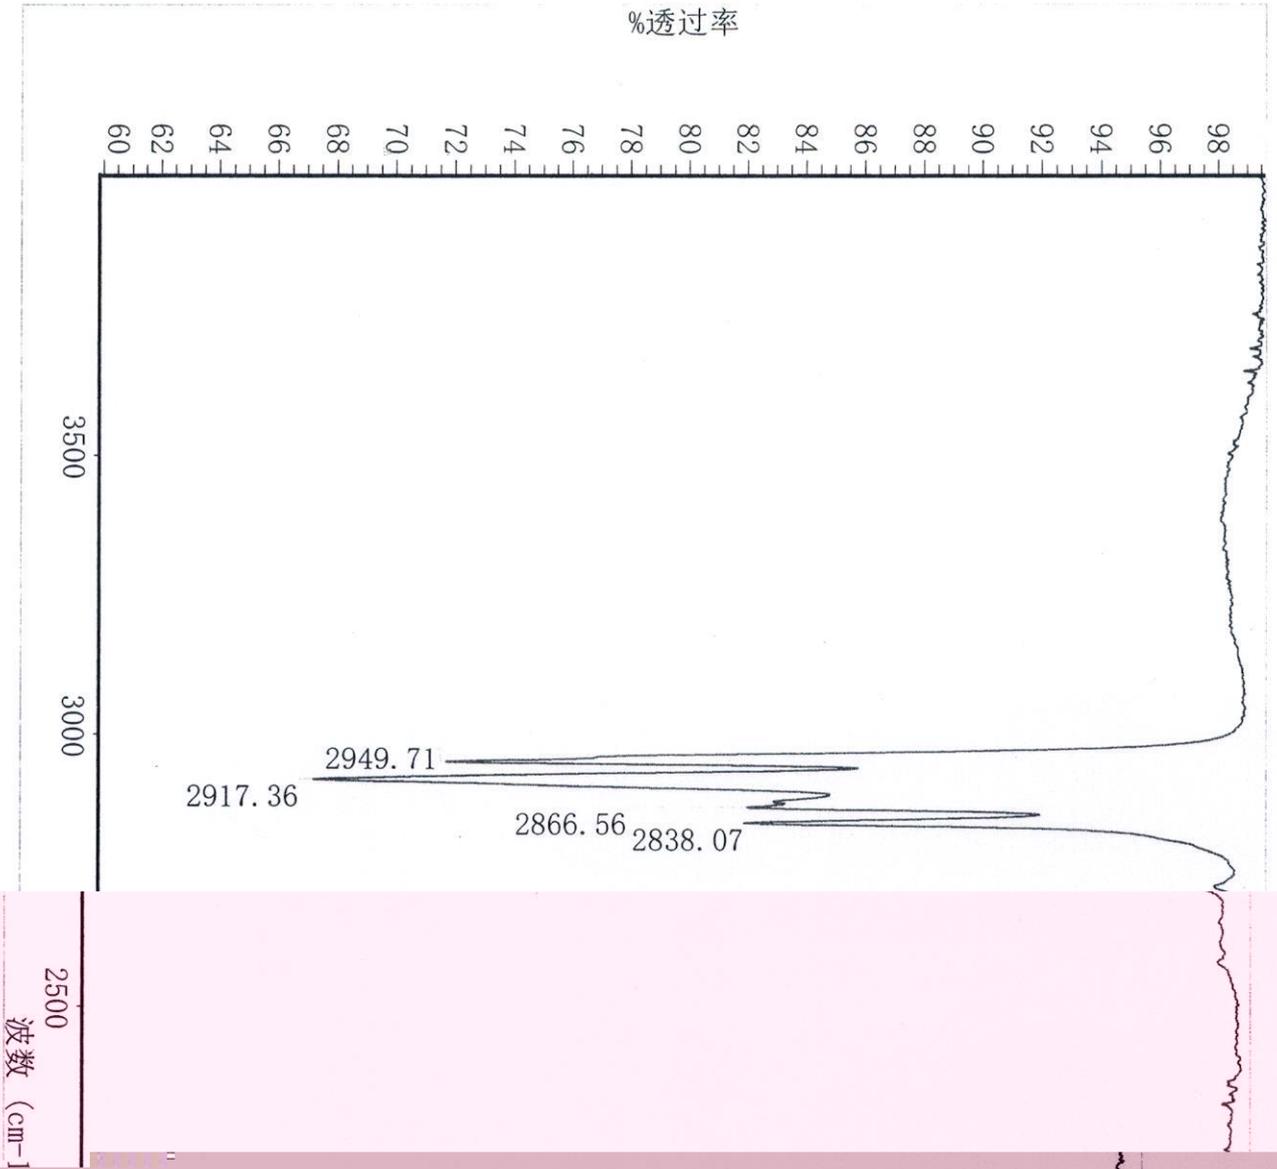

星期
- 6月 13 11:11:45 2022 (GMT+8:00)

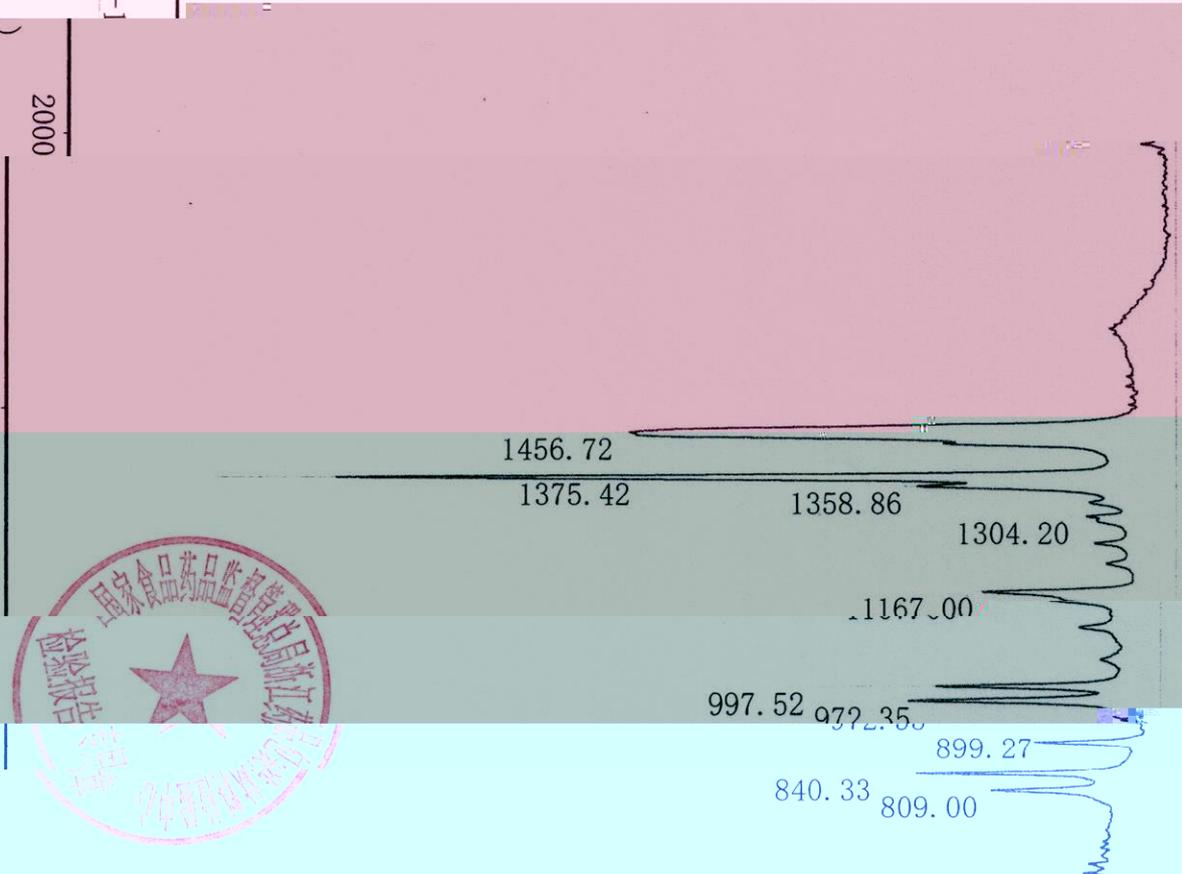

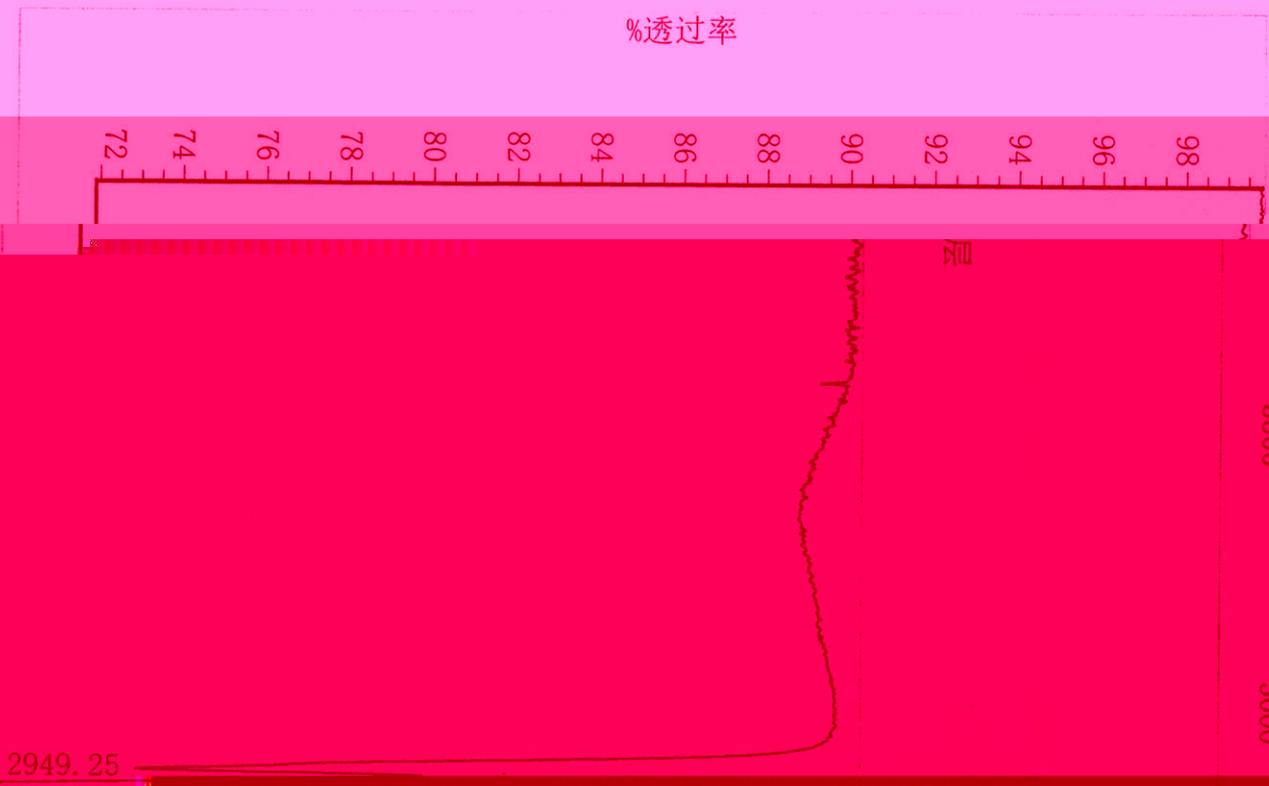

2949.25

3500 3000